


THE LANCET に掲載されました。

Drug-eluting stents in elderly patients with coronary artery disease(SENIOR): a randomized single-blind trial


試験のポイント

- 75歳以上を対象に行った試験で登録された患者の平均年齢は81歳
- ACS患者が47%含まれる
- SYNERGY™群はBMS群と比較して統計学的に有意な差をもってMACCE発生率が低い
- 75歳以上の高齢者を対象に、医師が1か月(Stable)または6か月(ACS)DAPTを宣言してから登録を行い試験を実施した結果、SYNERGY群はBMS群と同等の安全性を示した
- Def/Probのステント血栓症発生率は0.5%

SENIOR 試験デザイン (75歳以上の高齢者対象)

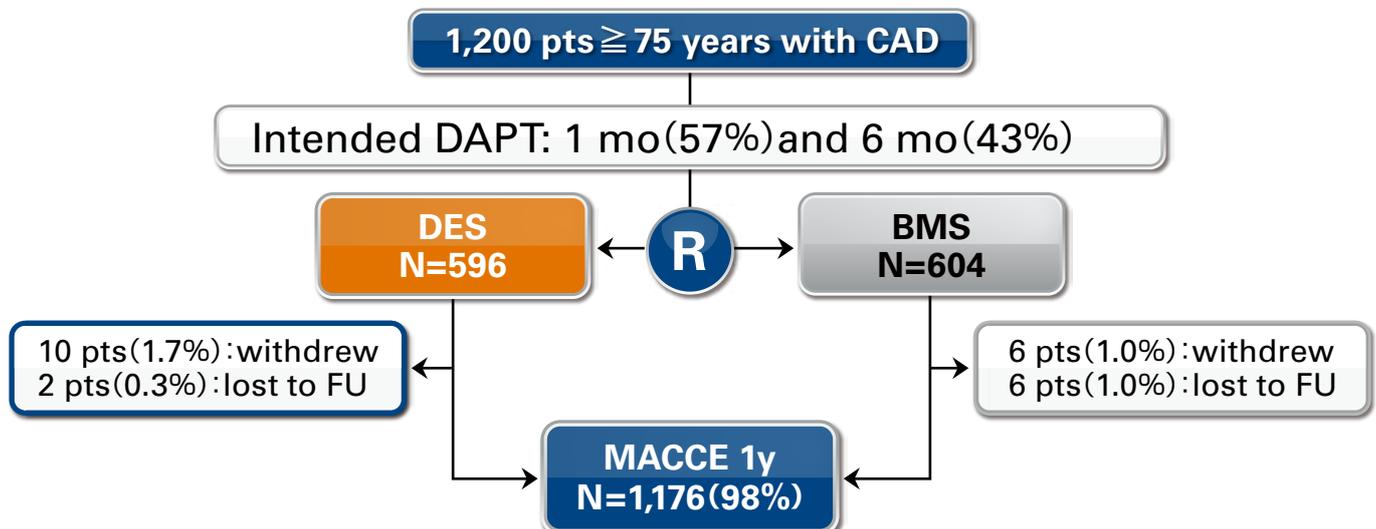


12か月時点 主要評価項目 MACCE
SYNERGY™ 群は、BMS群より29%MACCE発生率を低減

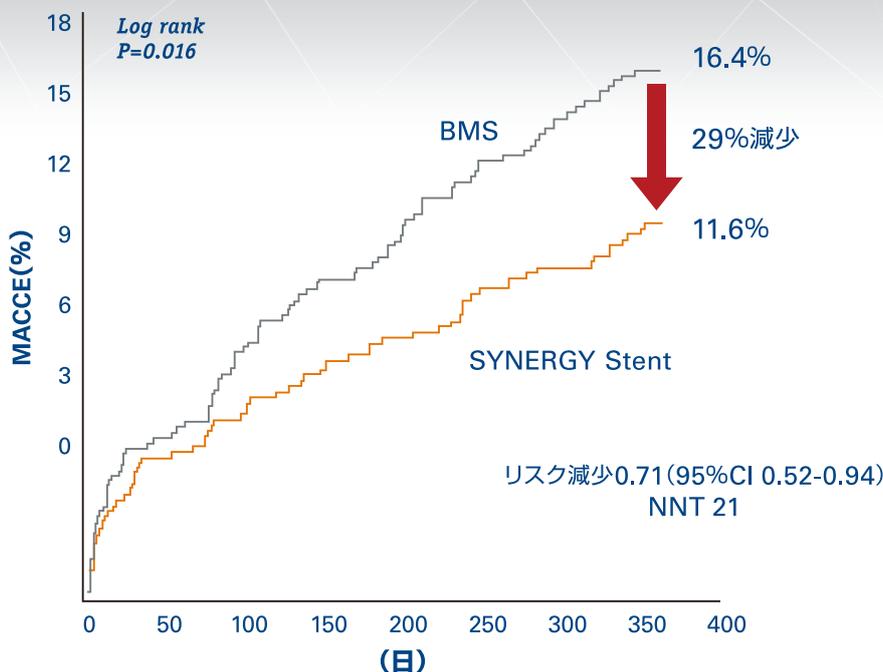

出典元: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32713-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32713-7)

12か月時点 有効性／安全性評価項目
1か月DAPT下において、SYNERGY群はBMS群と同等の安全性を示した

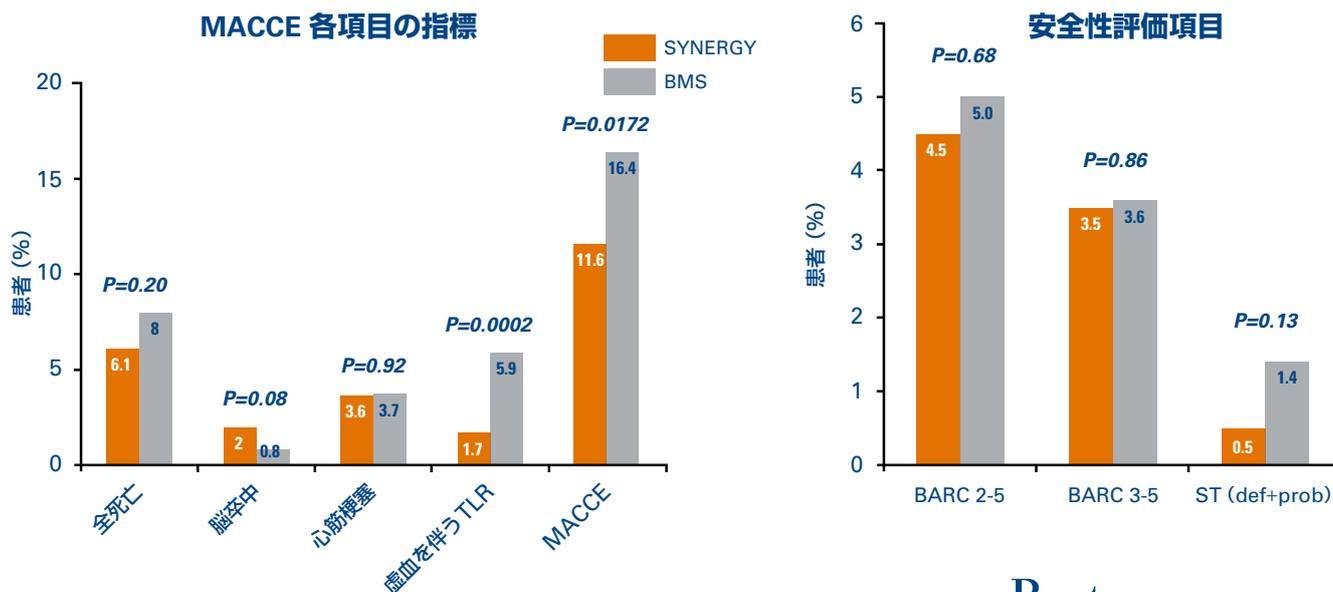

出典元: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32713-7](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32713-7)

Boston Scientific
Advancing science for life™

販売名: シナジー スtentシステム
医療機器承認番号: 22700BZX00372000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

製造販売元:
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1909-13281-2 / PSST20190903-0854